



Lietošanas pamācība

RadiForce® MX317W

Krāsu LCD monitors

Svarīgi!







Pirms lietošanas noteikti jāizlasa lietošanas pamācība un uzstādīšanas rokasgrāmata.

- Uzstādīšanas rokasgrāmatā skatiet informāciju par monitora iestatījumiem un pielāgojumiem.
- Jaunākā informācija par produktu, tostarp lietošanas pamācība, ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē.

www.eizoglobal.com

DROŠĪBAS SIMBOLI

Šajā rokasgrāmatā un šim produktam ir izmantoti tālāk norādītie drošības simboli. Tie norāda uz kritisku informāciju. Lūdzu, izlasiet tos uzmanīgi.

 BRĪDINĀJUMS	BRĪDINĀJUMĀ sniegtās informācijas neievērošanas rezultātā var izraisīt nopietnu traumu un apdraudēt dzīvību.
 UZMANĪBU	Norādē UZMANĪBU sniegtās informācijas neievērošanas rezultātā var izraisīt mērenu traumu un/vai sabojāt tīpašumu vai produktu.
	Norāda uz brīdinājumu vai piesardzības pasākumu. Piemērs:  norāda uz “elektrošoka” risku.
	Norāda uz aizliegtu darbību. Piemērs:  nozīmē “Neizjaukt”.

Šis produkts ir noregulēts konkrēti izmantošanai reģionā, uz kuru tas sākotnēji tika nosūtīts. Ja produkts tiek izmantots ārpus šī reģiona, tas var nedarboties, kā norādīts specifikācijās.

Nevienu šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst pavairot, uzglabāt izguves sistēmā vai pārsūtīt nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem — elektroniski, mehāniski vai kā citādi — bez iepriekšējas rakstiskas EIZO Corporation atļaujas.

EIZO Corporation pienākums ir nodrošināt jebkura iesniegtā materiāla vai informācijas konfidencialitāti, ja nav veiktas iepriekšējas norunas saskaņā ar EIZO Corporation minētās informācijas saņemšanu. Kaut arī ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu to, ka šajā rokasgrāmatā ir ietverta atjaunināta informācija, lūdzu, ņemiet vērā, ka EIZO produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.


DROŠĪBAS PASĀKUMI

Svarīgi!

Šis produkts ir noregulēts konkrēti izmantošanai reģionā, uz kuru tas sākotnēji tika nosūtīts. Ja produkts tiek izmantots ārpus šī reģiona, tas var nedarboties, kā norādīts specifikācijās.

Personīgās drošības un pareizas apkopes nolūkos, lūdzu, uzmanīgi izlasiet sadaļu "DROŠĪBAS PASĀKUMI" un piesardzības paziņojumus uz monitora.

Piesardzības paziņojuma atrašanās vieta

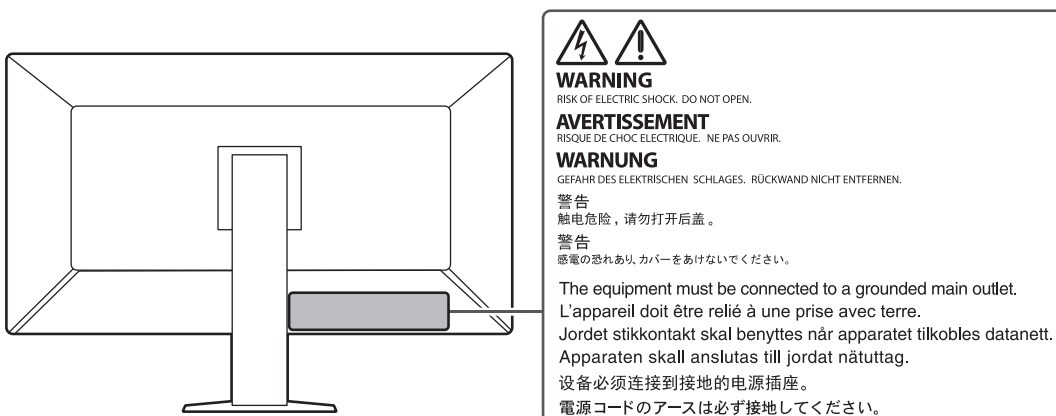

Uz iekārtas redzami simboli

Simbols	Šis simbols norāda
	Galvenais strāvas slēdzis: Nospiediet, lai izslēgtu monitora galveno strāvu.
	Galvenais strāvas slēdzis: Nospiediet, lai ieslēgtu monitora galveno strāvu.
	Barošanas poga: Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu monitora strāvu.
	Maiņstrāva
	Brīdinājums par elektrošoka risku
	UZMANĪBU! Skatiet DROŠĪBAS SIMBOLI [▶ 2]
	WEEE marķējums: produkts ir jālikvidē atsevišķi; materiālus var pārstrādāt.
	CE marķējums: ES atbilstības zīme saskaņā ar padomes direktīvu un/vai regulu noteikumiem (ES).
	Ražotājs
	Ražošanas datums
RXonly	Uzmanību! Federālais likums (ASV) ierobežo šīs ierīces pārdošanu tikai licencētiem praktizējošiem ārstiem veselības aprūpē vai pēc to pasūtījuma.
	Medicīniskā ierīce Eiropas Savienībā

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Simbols	Šis simbols norāda
EU Importer	Importētājs Eiropas Savienībā
	Zīme, kas apliecina atbilstību AK noteikumiem
	Atbildīgā persona AK
	Pilnvarotais pārstāvis Šveicē
	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā

BRĪDINĀJUMS**BRĪDINĀJUMS**

Ja ierīce sāk dūmot, parādās deguma aromāts vai savādi trokšņi, nekavējoties atvienojiet visus strāvas savienojumus un sazinieties ar EIZO pārstāvi, lai saņemtu ieteikumu.

Mēģinot izmantot disfunkcionālu ierīci, var izraisīt aizdegšanos, elektrošoku vai aprīkojuma bojājumus.

**BRĪDINĀJUMS**

Neizjauciet ierīci un nepārveidojiet to.

Atverot nodalījumu, augstspriegums vai augstas temperatūras daļas var izraisīt elektrošoku vai apdegumus. Ierīces modificēšana var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.

**BRĪDINĀJUMS**

Visu apkopes darbu veikšanu uzticiet kvalificētam apkopes personālam.

Nemēģiniet veikt šī produkta apkopi pats, jo aizsegu atvēršana vai noņemšana var izraisīt aizdegšanos, elektrošoku vai aprīkojuma bojājumus.

**BRĪDINĀJUMS**

Nepieļaujiet, ka iekārtas tuvumā atrodas svešķermeņi vai šķidrums.

Metāla daļas, viegli uzliesmojoši materiāli vai šķidrums, kas nejauši iekļūst nodalījumā, var izraisīt aizdegšanos, elektrošoku vai aprīkojuma bojājumus.












Ja kāds priekšmets vai šķidrums iekrīt/iešļakstās nodalījumā, nekavējoties atslēdziet iekārtu. Pirms atkārtotas iekārtas izmantošanas tā jāpārbauda kvalificētam apkopes inženierim.












**BRĪDINĀJUMS**

Novietojiet iekārtu stingrā un stabilā vietā.







Uz nepiemērotas virsmas novietota ierīce var nokrist un izraisīt traumu.











Ierīces kritiena gadījumā nekavējoties atvienojiet strāvu un lūdziet padomu vietējam EIZO pārstāvim. Neturpiniet lietot bojātu ierīci. Bojātas ierīces izmantošana var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.

<p> BRĪDINĀJUMS</p>	
<p>Izmantojiet iekārtu piemērotā vietā.</p> <p>Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks, iestāties elektrošoks vai tikt bojāts aprīkojums.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenovietojiet ārā. • Neievietojiet transportlīdzeklī (piemēram, kuģī, lidmašīnā, vilcienā, automašīnā u. c.). • Nenovietojiet putekļainā vai mitrā vidē. • Nenovietojiet vietā, kur uz ekrāna var uzšļakstīties ūdens (piemēram, vannas istabā, virtuvē u. c.) • Nenovietojiet vietā, kur tvaiki nonāk tiešā saskarē ar ekrānu. • Nenovietojiet siltumradošu ierīču vai mitrinātāju tuvumā. • Nenovietojiet vietā, kur produkts ir pakļauts tiešai saules gaismas ietekmei. • Nenovietojiet vidē, kurā ir uzliesmojoša gāze. • Nenovietojiet vidē, kurā ir korozīvas gāzes, piemēram, sēra dioksīds, sērūdeņradis, slāpekļa dioksīds, hlors, amonjaks vai ozons. • Nenovietojiet vidē, kurā ir putekļi vai atmosfēra ar koroziju paātrinošām sastāvdaļām, piemēram, nātrija hlorīdu vai sēru, strāvas vadītāji metāli utt. 	
	
<p> BRĪDINĀJUMS</p>	
<p>Plastikāta iepakojumus uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.</p> <p>Plastikāta iepakojums var izraisīt nosmakšanu.</p>	
<p> BRĪDINĀJUMS</p>	
<p>Izmantojiet komplektā iekļauto strāvas vadu un savienojiet to ar savas valsts standarta kontaktligzdu.</p> <p>Vienmēr ievērojiet strāvas vada nominālo spriegumu. Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks vai iestāties elektrošoks.</p> <p>Elektroapgāde: 100–240 V maiņstrāva 50/60 Hz</p>	
<p> BRĪDINĀJUMS</p>	
<p>Lai atvienotu strāvas vadu, stingri satveriet un pavelciet kontaktdakšu.</p> <p>Raujot aiz vada, to var sabojāt un izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.</p>	
<div style="display: flex; align-items: center;">  OK   </div>	
	
<p> BRĪDINĀJUMS</p>	
<p>Aprīkojumam jābūt savienotam ar iezemētu strāvas kontaktligzdu.</p> <p>Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.</p>	
	

 BRĪDINĀJUMS	
Lietojiet atbilstošu spriegumu.	
<ul style="list-style-type: none"> Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai ar konkrētu spriegumu. Savienojums ar citu spriegumu, kas atšķiras no šajā "Lietošanas pamācībā" norādītā, var izraisīt aizdegšanos, elektrošoku vai aprīkojuma bojājumus. Elektroapgāde: 100–240 V maiņstrāva 50/60 Hz Nepārslogojiet strāvas kontūru, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu. 	
 BRĪDINĀJUMS	
Ar strāvas vadu rīkojieties uzmanīgi.	
Uz tā nedrīkst novietot smagus priekšmetus, kā arī nedrīkst vilkt aiz strāvas vada. Bojāta strāvas vada izmantošana var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.	
 BRĪDINĀJUMS	
Operators nedrīkst pieskarties pacientam, vienlaikus pieskaroties produktam.	
Šis produkts nav paredzēts, lai tam pieskartos pacienti.	
 BRĪDINĀJUMS	
Negaisa laikā nekad neaizskariet kontaktdakšu un strāvas vadu.	
Pieskaršanās tiem var izraisīt elektrošoku.	
 BRĪDINĀJUMS	
Pievienojot sviras statīvu, lūdzu, skatiet informāciju sviras statīva lietotāja rokasgrāmatā un droši uzstādiet ierīci.	
<p>Pretējā gadījumā ierīce var atdalīties, izraisot traumu vai aprīkojuma bojājumus.</p> <p>Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai galdu, sienu un citu uzstādīšanas virsmu mehāniskā stiprība ir pietiekama.</p> <p>Ierīces kritiena gadījumā nekavējoties atvienojiet strāvu un lūdziet padomu vietējam EIZO pārstāvim. Neturpiniet lietot bojātu ierīci. Bojātas ierīces izmantošana var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku. Pievienojot savēršanas statīvu, lūdzu, izmantojiet tās pašas skrūves un tās cieši pievelciet.</p>	
 BRĪDINĀJUMS	
Nepieskarieties tieši bojātam LCD panelim ar kailām rokām.	
<p>Ja kāda jūsu ādas daļa nonāk tiešā saskarē ar paneli, rūpīgi nomazgājiet ādu.</p> <p>Ja šķidrās kristāls iekļūst acīs vai mutē, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu ūdens daudzumu un meklējiet medicīnisko palīdzību. Pretējā gadījumā var būt toksiska reakcija.</p>	
 BRĪDINĀJUMS	
Lai veiktu uzstādīšanu augstās atrašanās vietās, lūdziet speciālista palīdzību.	
<p>Monitoru uzstādot augstā atrašanās vietā, pastāv risks, ka produkts vai tā daļas var nokrist un izraisīt traumas. Lūdziet palīdzību mums vai speciālistam, kurš specializējas būvniecībā, kad uzstādāt monitoru, tostarp veicat pārbaudi, vai produktam nav bojājumu vai deformāciju gan pirms, gan pēc monitora uzstādīšanas.</p>	

UZMANĪBU

<p> UZMANĪBU</p>
<p>Pirms lietošanas pārbaudiet ierīces darbības stāvokli. Lietošanas sākumā pārliedzinieties, vai attēla parādīšana nerada problēmas. Lietojot vairākas ierīces, lietošanas sākumā pārliedzinieties, vai attēli tiek atbilstoši parādīti.</p>
<p> UZMANĪBU</p>
<p>Stingri nostipriniet kabeļus/vadus, kuriem ir stiprinājuma elements. Stingri nenostiprinot, kabeļi/vadi var atvienoties, un tā rezultātā var tikt atslēgta attēlu demonstrēšana un pārtrauktas jūsu veiktās darbības.</p>
<p> UZMANĪBU</p>
<p>Pārvietojot iekārtu, atvienojiet kabeļus un noņemiet piederumus. Pretējā gadījumā kabeļi vai piederumi pārvietojot var atdalīties, izraisot traumas.</p>
<p> UZMANĪBU</p>
<p>Nesiet vai novietojiet ierīci atbilstoši pareizām norādītajām metodēm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pārvietojot ierīci, stingri turiet monitora apakšdaļu. • Monitori ar 30 collu un lielāku ekrānu ir smagi. Izsaiņojot un/vai pārvietojot monitoru, nodrošiniet, ka to veic vismaz divi cilvēki. • Ja monitora aizmugurē ir rokturis, satveriet un stingri turiet monitora apakšdaļu un rokturi. <p>Ierīces kritiens var izraisīt traumu vai aprīkojuma bojājumus.</p> <div data-bbox="375 1187 1165 1355"> </div>
<p> UZMANĪBU</p>
<p>Ievērojiet piesardzību, lai nenaspiestu rokas. Ja pēkšņi lietojat spēku monitoram, lai regulētu tā augstumu vai leņķi, jūsu rokas var tikt saspiestas un traumētas.</p>
<p> UZMANĪBU</p>
<p>Nenobloķējiet nodalījuma ventilācijas atveres.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenovietojiet uz ventilācijas atverēm nekādus priekšmetus. • Neuzstādiet ierīci nepietiekami vēdināmā vai neatbilstošā vietā. • Neizmantojiet ierīci, kas nolikta guļus vai ar augšpusi uz leju. <p>Nosprostoņot ventilācijas atveres, tiek traucēta pareiza gaisa plūsma un var tikt izraisīta aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens vai aprīkojuma bojājumi.</p>

 UZMANĪBU	<p>Neaizskariet kontaktdakšu ar mitrām rokām. Pieskaršanās tiem var izraisīt elektrošoku.</p>  
 UZMANĪBU	<p>Nenovietojiet ap kontaktdakšu nekādus priekšmetus. Tas atvieglos kontaktdakšas atvienošanu problēmu gadījumā, lai nepieļautu aizdegšanos vai elektrošoku.</p> 
 UZMANĪBU	<p>Periodiski notīriet zonu ap strāvas spraudni un monitora vēdināšanas vietu. Šai zonai pielipuši putekļi, ūdens vai eļļa var izraisīt aizdegšanos.</p>
 UZMANĪBU	<p>Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no kontaktligzdas. Tīrot kontaktligzdai pieslēgtu ierīci, var izraisīt elektrošoku.</p>
 UZMANĪBU	<p>Ja plānojat ilgāku laiku neizmantot ierīci, pēc strāvas slēdža izslēgšanas atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas drošības un enerģijas taupīšanas nolūkos.</p>
 UZMANĪBU	<p>Likvidējiet šo izstrādājumu saskaņā ar vietējām vai uzturēšanās valsts tiesību normām.</p>
 UZMANĪBU	<p>Lietotājiem EEZ teritorijā un Šveicē: Par visiem nopietniem incidentiem, kas radušies saistībā ar ierīci, ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai varas iestādei, kura ir lietotāja un/vai pacienta mītnes vieta.</p>

Paziņojums par šo monitoru

Lietošanas indikācijas

Šo produktu ir paredzēts izmantot radioloģisko attēlu rādīšanai, lai apmācīti medicīnas speciālisti tos pārskatītu, analizētu un izmantotu diagnozes noteikšanai. Displejs nav paredzēts mamogrāfijai.

Uzmanību

- Šis izstrādājums nav paredzēts in vitro diagnostikai.
- Ja šis produkts tiek lietots citiem nolūkiem, izņemot šajā rokasgrāmatā aprakstītos, uz to var neattiekties garantija.
- Šajā rokasgrāmatā norādītās specifikācijas ir spēkā tikai tad, ja tiek izmantoti produkta komplektācijā iekļautie strāvas vadi un EIZO norādītie signāla kabeli.
- Ar šo produktu izmantojiet tikai EIZO norādītos EIZO piederumu produktus.

Drošības pasākumi lietojot

- Ja tiek lietotas ilgstoši, atsevišķas detaļas (piemēram, LCD panelis un ventilators) var nolietoties. Regulāri pārbaudiet, vai tās darbojas normāli.
- Ja ekrāna attēls tiek mainīts pēc viena un tā paša attēla rādīšanas ilgāku laika periodu, var palikt pēcattēls. Izmantojiet ekrānsaudzētāju vai enerģijas saudzēšanas funkciju, lai izvairītos no tā paša attēla rādīšanas ilgākā laika periodā. Pēcattēls var parādīties pat pēc īsa laika perioda atkarībā no parādītā attēla. Lai novērstu šādu parādību, nomainiet attēlu vai izslēdziet strāvas padevi uz dažām stundām.
- Lai monitora displejs nostabilizētos, ir nepieciešamas vairākas minūtes. Pirms monitora lietošanas pēc monitora ieslēgšanas vai atmodināšanas no enerģijas taupīšanas režīma, lūdzu, uzgaidiet dažas minūtes.
- Ja monitors ir pastāvīgi ieslēgts ilgā laika periodā, var parādīties tumši vai izdeguši plankumi. Lai maksimāli palielinātu monitora darbmužu, ieteicams regulāri izslēgt monitoru.
- LCD paneļa aizmugurgaismojumam ir fiksēts kalpošanas laiks. Atkarībā no lietošanas biežuma, piemēram, nepārtraukti lietojot ilgstošos laika posmos, fona izgaismojuma kalpošanas laiks var samazināties un to var būt nepieciešams nomainīt. Ja ekrāns kļūst tumšs vai sāk ņīrbēt, lūdzu, sazinieties ar vietējo EIZO pārstāvi.
- Ekrānā var būt bojāti pikseli vai nedaudzi gaiši punkti. Tās ir paša LCD paneļa iezīmes, nevis produkta disfunkcija.
- Nespiediet stipri uz LCD paneļa virsmu vai ārējo rāmi, jo tas var izraisīt displeja disfunkciju, piemēram, traucējumus. Ja LCD panelim spiediens tiek piemērots pastāvīgi, var pasliktināties tā kvalitāte, un tas var sabojāties. (Ja uz LCD paneļa parādās spiediena zīmes, atstājiet monitoru ar melnu vai baltu ekrānu. Šī pazīme var pazust.)
- Neskrāpējiet un nespiediet LCD paneli ar asiem priekšmetiem, jo tas var izraisīt LCD paneļa bojājumus. Nemēģiniet tīrīt ar salvetēm, jo tā var saskrāpēt paneli.
- Nepieskarieties iebūvētajam kalibrēšanas sensoram (integrētais priekšējais sensors). Pretējā gadījumā iespējams samazināt mērījumu precizitāti vai izraisīt aprīkojuma bojājumus.
- Atkarībā no vides iebūvētā apgaismojuma sensora izmērītā vērtība var atšķirties no savrupā apgaismojuma mērītājā redzamās vērtības.
- Ja produkts tiek pārvietots uz aukstu telpu, temperatūra pēkšņi palielinās vai tas tiek pārvietots no aukstas telpas uz siltu, produkta iekšpusē vai uz tā virsmas var veidoties

rasas kondensāts. Šādā gadījumā neieslēdziet produktu. Tā vietā pagaidiet, līdz pazūd rasas kondensāts, lai novērstu produkta bojājumus.

Ilgstošs monitora lietojums

Kvalitātes pārbaude

- Monitoru rādīšanas kvalitāti ietekmē ievades signālu kvalitātes līmenis un produkta degradācija. Veiciet vizuālās pārbaudes un periodiskās pastāvīguma pārbaudes (tostarp pelēkskalas pārbaudi), ievērojot medicīniskos standartus/vadlīnijas atbilstoši savam pielietojumam; nepieciešamības gadījumā veiciet kalibrēšanu. RadiCS (izvēles) monitora kvalitātes pārbaudes programmatūra sniedz iespēju veikt kvalitātes pārbaudi atbilstoši medicīniskajiem standartiem/vadlīnijām.
- Kad monitors ir ieslēgts vai tā darbība ir atjaunota pēc enerģijas taupīšanas režīma, lūdzu, uzgaidiet 15 minūtes un pēc tam veiciet kvalitātes pārbaudi, kalibrācijas pārbaudi vai monitora ekrāna regulēšanu.
- Lai mazinātu ilgstoša lietojuma izraisītas spīduma izmaiņas un saglabātu spilgtuma stabilitāti, iesakām iestatīt monitorus uz ieteikto līmeni vai zemāku.
- Lai pielāgotu integrētā kalibrēšanas sensora (integrēta priekšējā sensora) mērījumu rezultātus ārēja sensora, ko pārdod atsevišķi, mērījumu rezultātiem, jāveic korelācija starp integrēto priekšējo sensoru un ārējo sensoru, izmantojot RadiCS (izvēles piederums)/RadiCS LE (iekļauts). Periodiska korelācija palīdz uzturēt integrētā priekšējā sensora mērījumu rezultātu ārējam sensoram līdzvērtīgā līmenī. Sīkāku informāciju par korelāciju skatiet RadiCS/RadiCS LE lietotāja rokasgrāmatā.

Uzmanību

- Monitora displeja statuss var neparedzēti mainīties darbības kļūdas vai neparedzētas iestatījumu maiņas dēļ. Pēc monitora ekrāna regulēšanas ieteicams izmantot monitoru ar bloķētiem darbības slēdžiem. Informāciju par iestatīšanu skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā (CD-ROM).

Tīrīšana

- Lai produkts ilgstoši izskatītos jauns un lai paildzinātu tā kalpošanas laiku, ieteicams to regulāri tīrīt.
- Traipus no produkta var notīrīt, maigi noslaukot to ar mīkstu drānu, kas daļēji samitrināta ūdenī, vai izmantojot mūsu ScreenCleaner.

Uzmanību

- Nepieļaujiet šķidrums nonākšanu tiešā saskarē ar produktu. Ja tā notiek, nekavējoties noslaukiet to.
- Nepieļaujiet šķidrums iekļūšanu spraugās vai produkta iekšpusē.
- Izmantojot ķīmikālijas tīrīšanai vai dezinfekcijai, tādas ķīmikālijas kā, piemēram, spirts un dezinfekcijas līdzekļi, var izraisīt produkta spīduma izmaiņas, blāvojumu un izbalēšanu, kā arī parādītā attēla kvalitātes pasliktināšanos. Ķīmikālijas nelietojiet bieži.
- Nekad neizmantojiet šķīdinātāju, benzolu, vasku vai abrazīvu tīrīšanas līdzekli, kas var sabojāt produktu.
- Lai iegūtu papildinformāciju par tīrīšanu un dezinfekciju, skatiet mūsu tīmekļa vietni. Kā pārbaudīt: lai meklētu, atveriet vietni www.eizoglobal.com un vietnes meklēšanas lodziņā ierakstiet "disinfect".

Dezinfekcija ar ķīmikālijām

- Dezinficējot produktus, iesakām izmantot ķīmikālijas, kuras esam testējuši (skatīt tabulu zemāk). Ņemiet vērā, ka šo ķīmikāliju izmantošana negarantē, ka produkts netiks bojāts vai pasliktināts.

Kategorija	Ķīmikālijas veids	Produkta piemērs
Uz spirta bāzes	Etanols (etilspirts)	Etanols
Uz spirta bāzes	Izopropanols	Izopropilspirts (IPA)
Biguanīds	Hlorheksidīna glikonāts	Hibitane šķīdums
Uz spirta bāzes	Benzalkonija hlorīds	Welpas
Uz aldehīdu bāzes	Glutarāls	SteriHyde
Uz aldehīdu bāzes	Glutarāls	Cidex Plus28
Amfotērās virsmas aktīvā viela	Alkildiaminoetilglicīna hidrochlorīds	Satenidīna šķīdums

Ērtai monitora izmantošanai

- Pārāk tumšs vai gaišs ekrāns var ietekmēt jūsu redzi. Pielāgojiet monitora spilgtumu atbilstoši vides apstākļiem.
- Ilgstoša skatīšanās monitorā nogurdina acis. Nepieciešams 10 minūšu pārtraukums ik pēc stundas.
- Skatieties uz ekrānu no pareiza attāluma un pareizā leņķī.

Kiberdrošības brīdinājumi un pienākumi

- Aparātprogrammatūras atjaunināšana jāveic ar uzņēmuma EIZO Corporation vai tā izplatītāja starpniecību.
- Ja uzņēmums EIZO Corporation vai tā izplatītājs norāda, ka ir jāveic aparātprogrammatūras atjaunināšana, dariet to nekavējoties.

SATURS

DROŠĪBAS PASĀKUMI	3
Svarīgi!	3
Piesardzības paziņojuma atrašanās vieta	3
Uz iekārtas redzami simboli	3
Paziņojums par šo monitoru	10
Lietošanas indikācijas	10
Drošības pasākumi lietojot	10
Ilgstošs monitora lietojums	11
Kvalitātes pārbaude	11
Tīrīšana	11
Dezinfekcija ar ķīmikālijām	12
Ērtai monitora izmantošanai	12
Kiberdrošības brīdinājumi un pienākumi	12
1 Ievads	15
1.1 Funkcijas	15
1.1.1 Brīvais izkārtojums	15
1.1.2 Vienkāršs vadojums	15
1.1.3 Atbalsta video displeju un barošanas avotu ar vienu USB C tipa kabeļa savienojumu	15
1.1.4 Hibrīds melnbaltais un krāsu displejs	16
1.1.5 Kvalitātes pārbaude	16
1.1.6 Dokstacijas funkcija	16
1.1.7 Telpu taupošs dizains	16
1.1.8 Monitora darbināšana ar peli un tastatūru	17
1.2 Iepakojuma saturs	18
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk	18
1.2.2 RadiCS LE	18
1.2.3 RadiCS LE lietošana	19
1.3 Vadīklas un funkcijas	20
1.3.1 Priekšpuse	20
1.3.2 Aizmugure	21
2 Uzstādīšana/savienošana	23
2.1 Pirms uzstādīšanas	23
2.1.1 Uzstādīšanas apstākļi	23
2.2 Savienotājkabeļi	24
2.3 Ieslēgšana	28
2.4 Ekrāna augstuma un leņķa regulēšana	29
3 Problēma Nav attēla	30

4	Specifikācijas.....	32
4.1	Specifikāciju saraksts.....	32
4.1.1	LCD panelis	32
4.1.2	Video signāli.....	32
4.1.3	USB.....	32
4.1.4	Tīkls	32
4.1.5	Jauda	33
4.1.6	Fiziskās specifikācijas.....	33
4.1.7	Darbības vides prasības	33
4.1.8	Transportēšanas/uzglabāšanas apstākļi.....	33
4.2	Saderīgās izšķirtspējas	34
4.3	Piederumi	34
	Pielikums.....	35
	Medicīnas standarts	35
	Iekārtas klasifikācija	35
	EMC informācija.....	36
	Paredzētā lietojuma apstākļi.....	36
	Tehniskie apraksti	37


1 levads

Pateicamies, ka izvēlējāties EIZO LCD krāsu monitoru.

1.1 Funkcijas

1.1.1 Brīvais izkārtojums

- Šis produkts ir aprīkots ar funkciju PbyP (attēls pēc attēla) un funkciju PinP (attēls attēlā), kas vienlaicīgi var atveidot līdz trim signāliem.

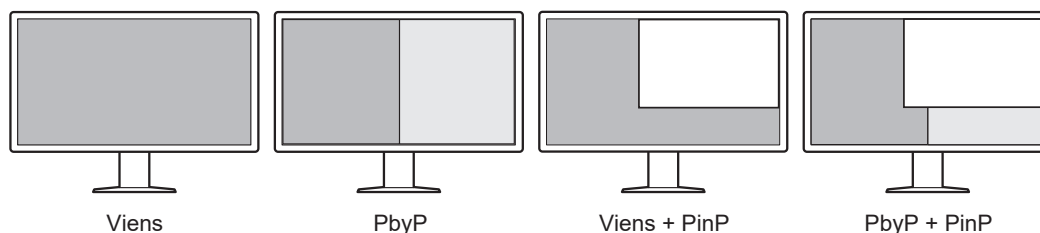


- Monitors nodrošina funkciju One Cable PbyP, kas parāda attēlus režīmā PbyP, izmantojot tikai vienu DisplayPort signāla kabeli.

1.1.2 Vienkāršs vadojums

Monitors ir aprīkots ar USB Type-C® (USB-C®) izvades termināli.


No izvades termināļa signālu var izvadīt uz citu monitoru.

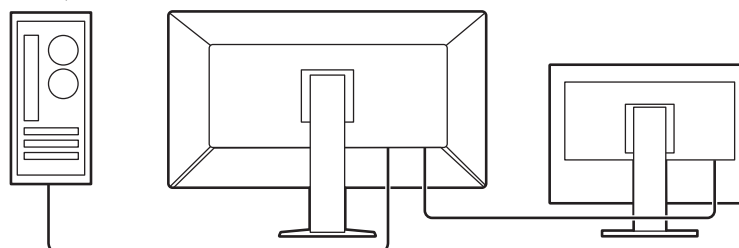

1.1.3 Atbalsta video displeju un barošanas avotu ar vienu USB C tipa kabeļa savienojumu

Šis izstrādājums ir aprīkots ar USB-C savienotāju un atbalsta video signālu pārraidi (DisplayPort™ Alt režīms), kā arī strāvas padevi (USB strāvas padeve).

Tas nodrošina maksimālu 94 W jaudu pievienotajam piezīmjdatoram, ja to izmanto kā ārējo monitoru.

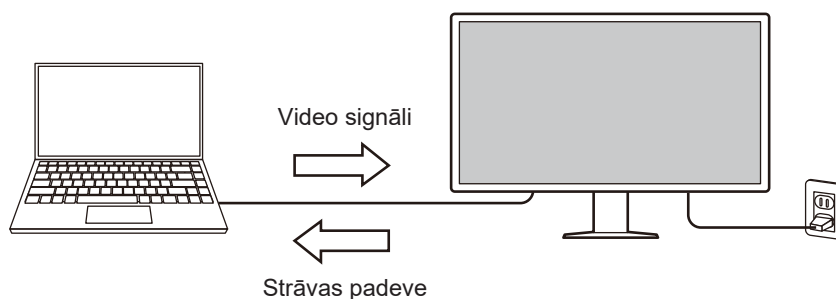

Piezīme

- Lai parādītu video signālus, pievienotajai ierīcei jāatbalsta video signālu pārraide (DisplayPort Alt režīms).
- Lai izmantotu uzlādes funkciju, pievienotajai ierīcei ir jāatbalsta ierīces uzlāde, izmantojot USB strāvas padevi.
- Tikai tad, ja tiek izmantoti tālāk norādītie USB kabeli, var nodrošināt maksimāli 94 W jaudu.
 - CC150SS81G-5A (iekļauts)
- Pievienotās ierīces var uzlādēt pat tad, ja monitors ir enerģijas taupīšanas režīmā.

1.1.4 Hibrīds melnbaltais un krāsu displejs


Kad iespējota Hybrid Gamma PXL funkcija, šī iekārta automātiski atšķir attēla melnbaltās un krāsainās daļas pikseļu līmenī un tās attiecīgi parāda ar optimāliem gradientiem.

1.1.5 Kvalitātes pārbaude


- Šim monitoram ir iebūvēts kalibrēšanas sensors (integrētais priekšējais sensors). Šis sensors neatkarīgi vienu no otras iespējo monitora veiktu kalibrēšanu (SelfCalibration (autonomo kalibrēšanu)) un pelēkskalas pārbaudi.
- Izmantojot iekļauto RadiCS LE, varat kalibrēt monitoru un pārvaldīt vēsturi.
- RadiCS monitora kvalitātes pārbaudes programmatūra sniedz iespēju veikt tādu kvalitātes pārbaudi, kāda atbilst medicīniskajiem standartiem / vadlīnijām.

1.1.6 Dokstacijas funkcija

Šis monitors ir aprīkots ar LAN portu un USB centrmezglu, kas ļauj to izmantot kā dokstaciju. Pievienojot USB C tipa kabeli, varat izveidot stabilu tīkla vidi pat piezīmjdatoros vai planšetdatoros, kas nav aprīkoti ar LAN portiem. Varat arī izmantot ar USB saderīgas perifērijas ierīces un uzlādēt viedtālrunus (skatiet sadaļu "Dokstacijas funkcijas izmantošana" instalēšanas rokasgrāmatā).

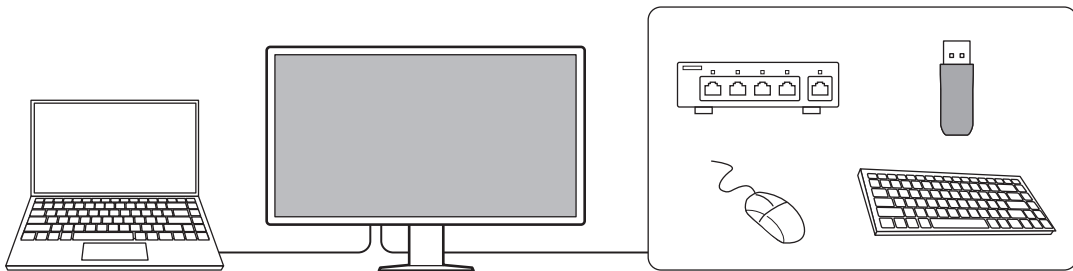**1.1.7 Telpu taupošs dizains**

Monitors ir aprīkots ar vairākiem USB savienotājiem (augšupielāde). Ir iespējams strādāt ar vairākiem datoriem, izmantojot vienu USB ierīču (pele, tastatūra u. c.) komplektu.

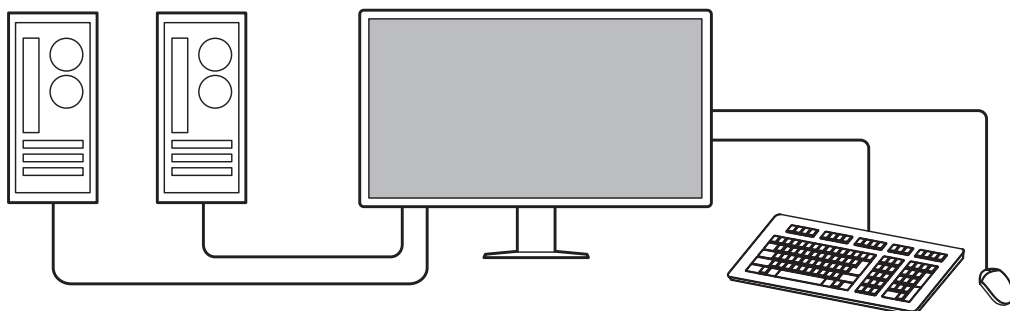

1.1.8 Monitors darbināšana ar peli un tastatūru

Lietojot RadiCS/RadiCS LE monitora kvalitātes pārbaudes programmatūru, ar peli un tastatūru var veikt tālāk minētās darbības ar monitoru.

- CAL slēdža režīmu pārslēgšana
- Ievades signālu pārslēgšana
- Funkcija, kas ekrāna daļai piešķir jebkādu CAL pārslēgšanas režīmu un parāda attēlu (norāda un iefokusē)
- PinP apakšloga rādīšana vai paslēpšana (Hide-and-Seek)
- Datoru, kuriem izmanto USB ierīces, pārslēgšana (Switch-and-Go)
- Ieiešana enerģijas taupīšanas režīmā (Backlight Saver)

Piezīme
<ul style="list-style-type: none">• RadiCS/RadiCS LE programmatūra sniedz iespēju vienlaikus rādīt vai paslēpt PinP apakšlogu un pārslēgt USB ierīču darbināšanā izmantoto datoru. Plašāku informāciju par iestatīšanas procedūru skatiet RadiCS / RadiCS LE lietotāja rokasgrāmatā.

1.2 Iepakojuma saturs

Pārbaudiet, vai iepakojums satur visus turpmākos priekšmetus. Ja kāds no tiem trūkst vai ir bojāts, sazinieties ar izplatītāju vai vietējo EIZO pārstāvi.

Piezīme

- Mēs iesakām saglabāt iepakojuma kasti un iepakojuma materiālus gadījumā, ja jūs vēlāk vēlētos pārvietot vai transportēt produktu.

- Monitors
- Barošanas vads



- Digitāla signāla kabelis (DisplayPort–DisplayPort): PP300-V14 x 2



- Digitālais signāla kabelis (no HDMI® uz HDMI): HH300PR x 1



- USB 2.0 kabelis (no USB-A uz USB-B): UU300 x 2



- USB-C kabelis (no USB-C uz USB-C): CC150SS81G-5A x 1



- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Lietošanas pamācība

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM satur šādus vienumus. Informāciju par programmatūras palaišanas procedūrām vai failu atsauces procedūrām skatiet diskā esošajā failā "Readme.txt".

- Readme.txt fails
- RadiCS LE monitora kvalitātes pārbaudes programmatūra (operētājsistēmai Windows)
- Lietotāja rokasgrāmata
 - Šī monitora lietošanas pamācība
 - Monitora uzstādīšanas rokasgrāmata
 - RadiCS LE lietotāja rokasgrāmata
- Ārējie izmēri

1.2.2 RadiCS LE

RadiCS LE sniedz iespēju veikt šādas kvalitātes pārbaudes un monitora darbības. Plašāku informāciju par programmatūru vai iestatīšanas procedūrām skatiet RadiCS LE lietotāja rokasgrāmatā.

Kvalitātes pārbaude

- Kalibrēšanas izpilde
- Pārbaudes rezultātu rādīšana saraksta formātā un pārbaudes ziņojuma izveide
- Autonomās kalibrēšanas mērķu un izpildes grafika izveide

Monitors darbības

- CAL slēdža režīmu pārslēgšana
- Ievades signālu pārslēgšana
- Funkcija, kas ekrāna daļai piešķir jebkādu CAL pārslēgšanas režīmu un parāda attēlu (norāda un iefokusē)
- PinP apakšloga rādīšana vai paslēpšana (Hide-and-Seek)
- Datoru, kuriem izmanto USB ierīces, pārslēgšana (Switch-and-Go)
- Ieiešana enerģijas taupīšanas režīmā (Backlight Saver)
- Funkcija, kas automātiski regulē monitora spilgtumu atbilstoši apkārtējā apgaismojuma līmenim, ja ir iestatīts teksta režīms (Auto Brightness Control)

Uzmanību
<ul style="list-style-type: none">• RadiCS LE specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Jaunākā RadiCS LE versija ir pieejama lejupielādei no mūsu tīmekļa vietnes: (www.eizoglobal.com)


1.2.3 RadiCS LE lietošana

Informāciju par to, kā instalēt un lietot RadiCS LE, skatiet RadiCS LE lietotāja rokasgrāmatā (CD-ROM).

Lietojot RadiCS LE, pievienojiet monitoru datoram ar piegādāto USB kabeli. Plašāku informāciju par to, kā pievienot monitoru, skatiet [2.2 Savienotājkabeļi](#) [► 24].



1.3 Vadīklas un funkcijas

1.3.1 Priekšpuse

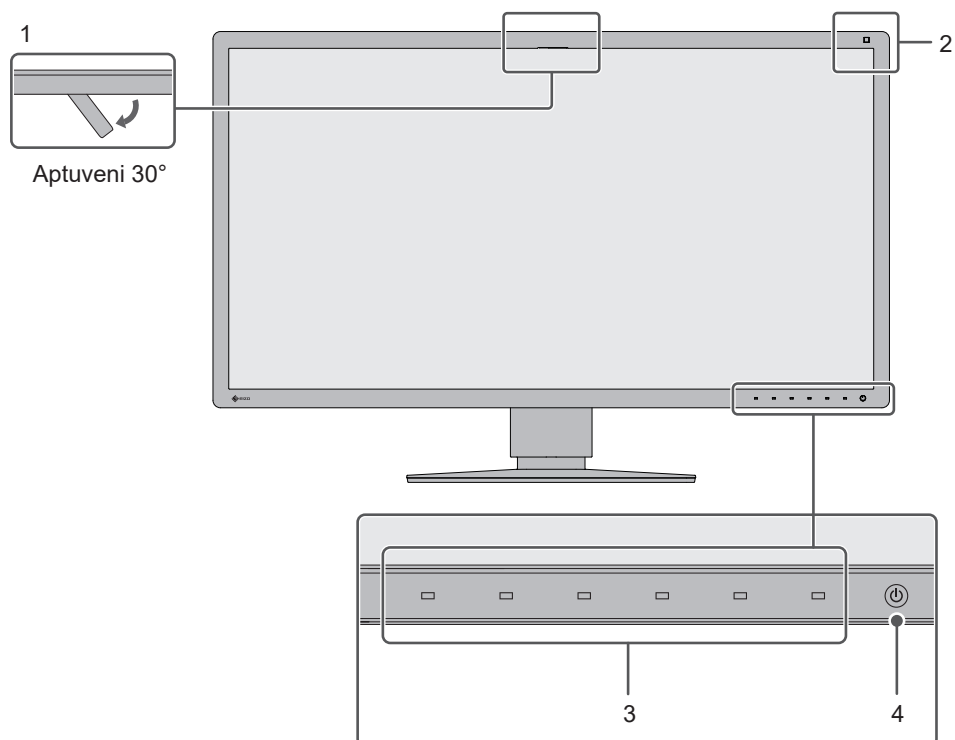

1. Integrētais priekšējais sensors (pārvietojams)	Šo sensoru lieto, lai veiktu kalibrēšanu un pelēkskalas pārbaudi.
2. Apgaismojuma sensors	Šis sensors mēra apkārtējās vides apgaismojumu. Vides apgaismojuma mērījumu veic, izmantojot RadiCS/RadiCS LE kvalitātes kontroles programmatūru.
3. Darbības slēdži	Rāda darbību norādes. Iestata izvēlnes atbilstoši darbību norādēm.
4. Jaudas slēdzis	<p>Ieslēdz vai izslēdz strāvas padevi.</p> <p>Ieslēdzot monitoru, slēdža indikators iedegas. Indikatora krāsa ir atkarīga no monitora darba stāvokļa.</p> <p>Zaļš: Parasts darbības režīms; oranža: Enerģijas taupīšanas režīms, izslēgts: atslēgts no elektroīkla, vai barošana ir izslēgta.</p>

1.3.2 Aizmugure

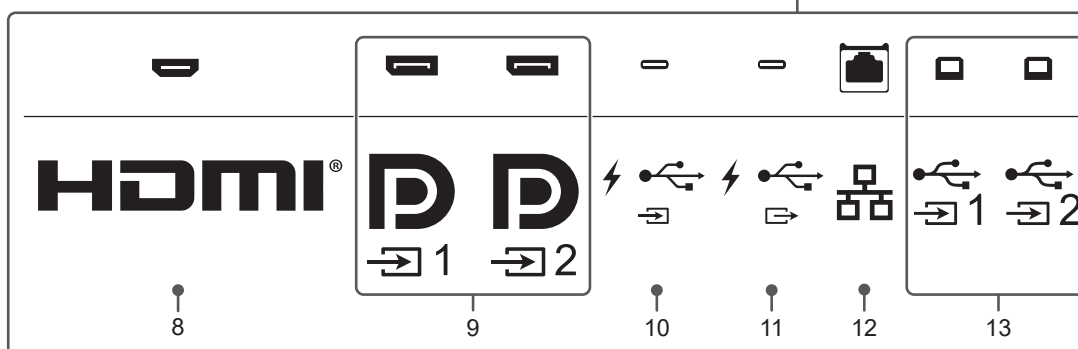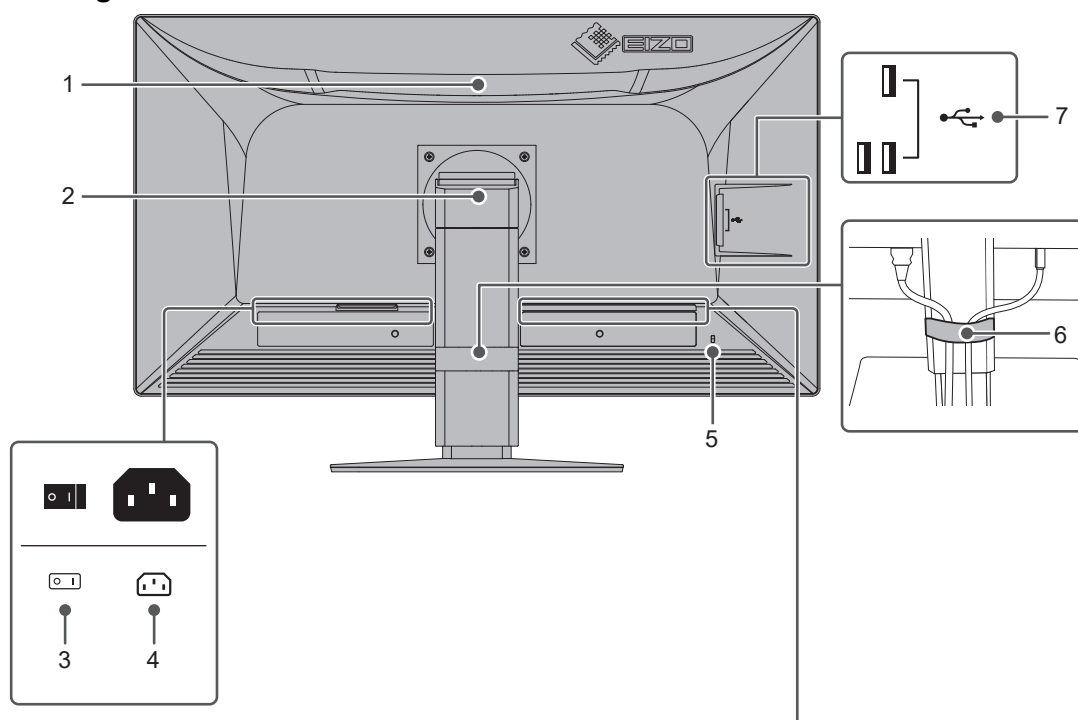

<p>1. Rokturis</p>	<p>Šo rokturi izmanto pārvietošanai.</p> <p>Uzmanību</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārnēsājot monitoru, cieši satveriet to aiz roktura un apakšējās daļas; nedrīkst iedarboties ar spiedienu pret LCD paneli vai nomest monitoru. Neturiet sensora daļu monitora priekšējā malā.
<p>2. Statīvs</p>	<p>Pielāgo monitora augstumu un leņķi (slīpumu un pagriezienu).</p>
<p>3. Galvenais strāvas slēdzis</p>	<p>Izslēdz vai izslēdz galveno strāvu.</p> <p>○ : Izslēgts, : Ieslēgts</p>
<p>4. Strāvas savienotājs</p>	<p>Pievieno strāvas vadu.</p>
<p>5. Drošības slēdzenes slots</p>	<p>Saderīgs ar Kensington MicroSaver drošības sistēmu.</p>
<p>6. Kabeļa turētājs</p>	<p>Tur monitora kabeļus.</p>
<p>7. USB-A savienotājs (lejupielāde)</p>	<p>Izveido savienojumu ar perifēro USB ierīci (skatiet sadaļu "Dokstacijas funkcijas izmantošana" uzstādīšanas rokasgrāmatā).</p>
<p>8. HDMI savienotājs</p>	<p>Savieno datoru ar HDMI izvadi.</p>
<p>9. DisplayPort savienotājs</p>	<p>Izveido savienojumu ar datoru, izmantojot DisplayPort izvadi.</p>
<p>10. USB-C savienotājs (augšupielāde)</p>	<p>Izveido savienojumu ar datoru, izmantojot USB-C izvadi. Tas pārraida arī USB signālu, kas nepieciešams, lai izmantotu</p>

	programmatūru, kurai nepieciešams USB savienojums vai dokstacijas funkcija (skatiet sadaļu "Dokstacijas funkcijas izmantošana" uzstādīšanas rokasgrāmatā).
11. USB-C savienotājs (lejupielāde)	Izveido savienojumu ar cita monitora USB-C augšupielādes savienotāju, kad tiek izveidots ziedlapķēdes savienojums. Turklāt var tikt izveidots arī savienojums ar perifēro USB ierīci (skatiet sadaļu "Dokstacijas funkcijas izmantošana" uzstādīšanas rokasgrāmatā).
12. LAN ports	Savieno ar tīkla centrmezglu vai maršrutētāju, izmantojot LAN kabeli, lai izmantotu dokstacijas funkcijas tīkla savienojumu (skatiet sadaļu "Dokstacijas funkcijas izmantošana" uzstādīšanas rokasgrāmatā).
13. USB-B savienotājs (augšupielāde)	Savieno ar datoru, ja izmantojat programmatūru, kurai nepieciešams USB savienojums, datorā bez USB-C savienojuma vai ja izmantojat šī izstrādājuma USB centrmezgla funkciju.

2 Uzstādīšana/savienošana

2.1 Pirms uzstādīšanas

Rūpīgi izlasiet norādījumus [DROŠĪBAS PASĀKUMI \[▶ 3\]](#) un vienmēr tos ievērojiet.

Ja šo produktu novietosiet uz lakota galda, gumijas sastāva dēļ krāsa var pielipt pie statīva pamatnes. Pirms lietošanas pārbaudiet galda virsmu.

2.1.1 Uzstādīšanas apstākļi

Uzstādot monitoru statīvā, nodrošiniet, lai monitora malās, aizmugurē un uz tā būtu pietiekami vietas.

Uzmanību

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Novietojiet monitoru tā, lai gaisma netraucētu ekrānam. |
|---|


2.2 Savienotājkabeļi

Uzmanību

- Pirms savienošanas pārbaudiet, vai monitors, dators un perifērās ierīces ir izslēgtas.
- Aizstājot pašreizējo monitoru ar šo monitoru, pirms datora pievienošanas skatiet sadaļu [4.2 Saderīgās izšķirtspējas \[► 34\]](#), lai veiktu izmaiņas datora izšķirtspējas un vertikālās meklēšanas frekvences iestatījumos, iestatot šim monitoram pieejamas vērtības pirms datora pievienošanas.
- Ja neizdodas ievietot kabeļus, pielāgojiet ekrāna leņķi.


1. Pievienojiet signāla kabeļus.
Pārbaudiet savienotāju formu un pievienojiet kabeļus.

Rādīšana vienā ekrānā

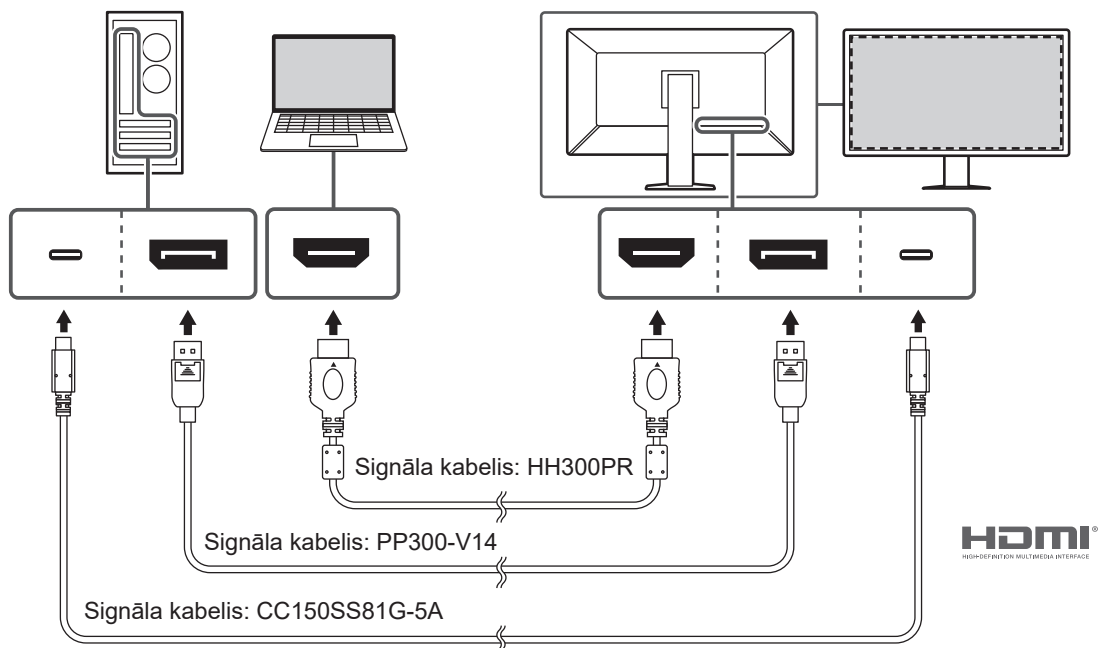


Uzmanību

- Rūpnīcas iestatījumos tiek parādīts DisplayPort 1 savienotāja signāls. Lai parādītu signālus no citiem savienotājiem, pārslēdziet ievades signālus (skatiet sadaļu "Ievades signālu pārslēgšana" uzstādīšanas rokasgrāmatā).
- HDMI signāli var tikt parādīti ierobežotā diapazonā.

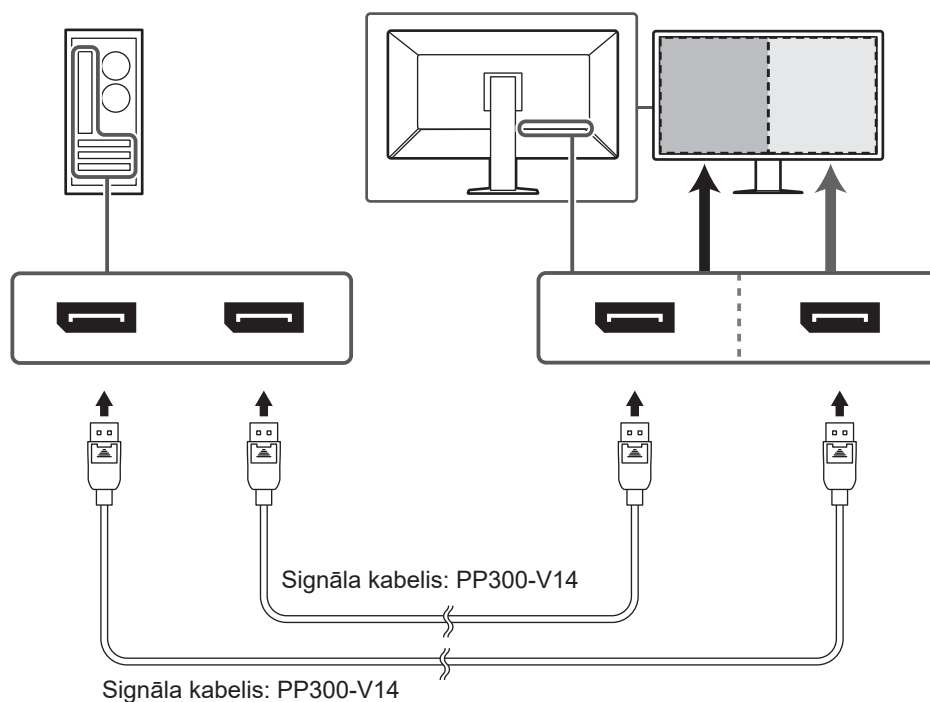
PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2) displejs**Uzmanību**

- Lai parādītu PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2), iestatījumu izvēlnē ir jāiestata "PbyP Settings". Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu (kompaktdiskā).
- Lietojot monitoru PbyP režīmā attēlu rādīšanai no diviem datoriem, dažu kvalitātes pārbaudes iezīmju, piemēram, kalibrēšanas, izmantojums var būt ierobežots.

PbyP (viena kabeļa PbyP) displejs

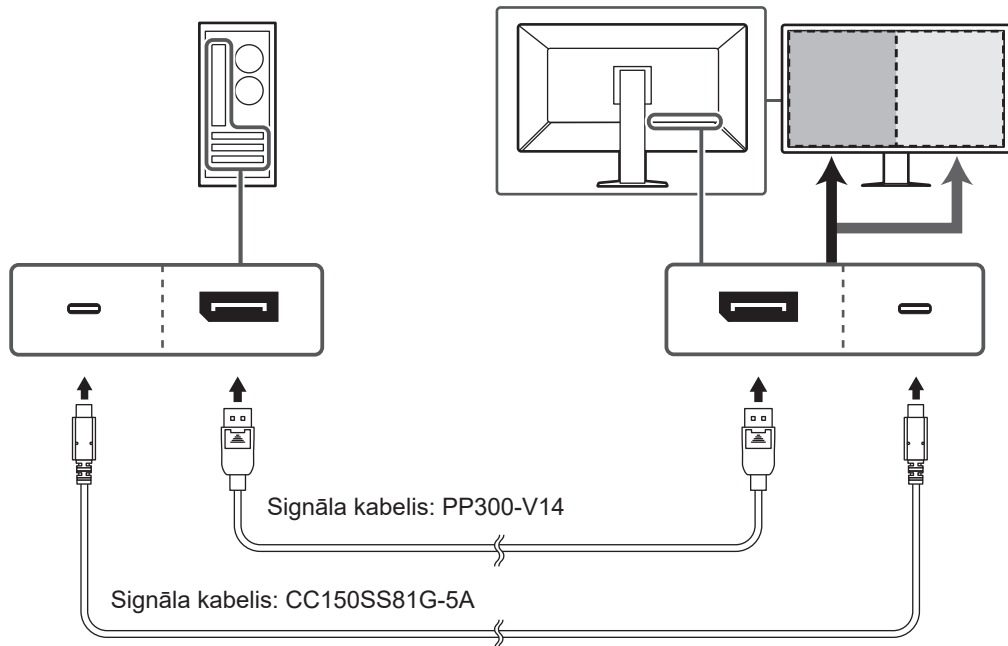


Uzmanību

- PbyP (One Cable PbyP) displejam pievienojiet DisplayPort 1 savienotāju vai USB-C savienotāju (augšupielāde: ) . Turklāt iestatījumu izvēlnē ir jāiestata "PbyP Settings". Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu (kompaktdiskā).

PinP (apakšloga) displejs

Piemērs. HDMI savienotāja izmantošana

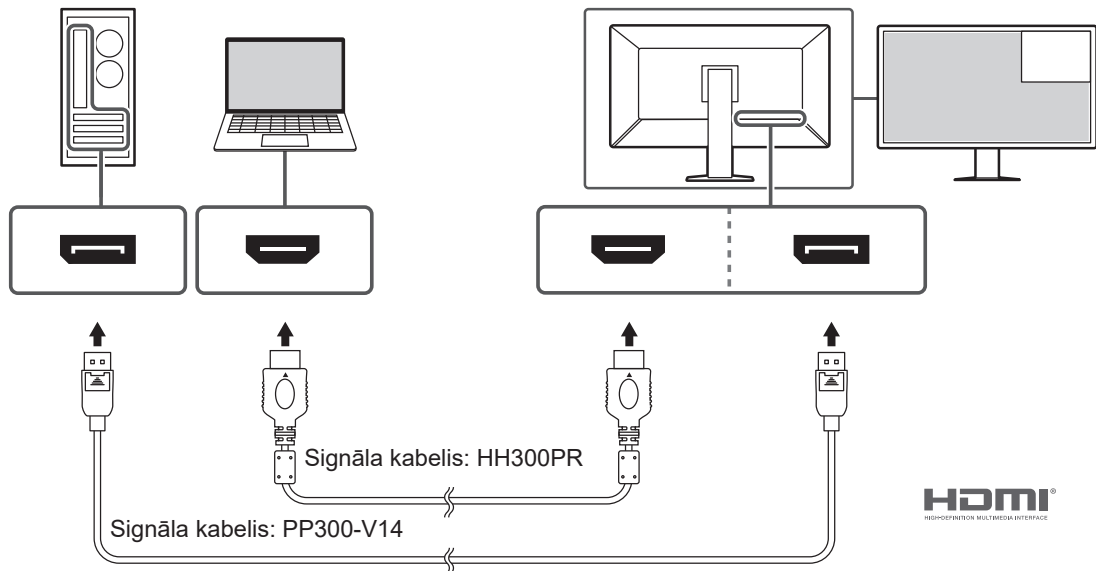



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Uzmanību



- PinP (apakšlogs) displejam iestatījumu izvēlnē ir jāiestata "PinP Settings". Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu (kompaktdiskā).
- Ja HDMI signāls tiek rādīts viena ekrāna režīmā, PinP (apakšlogs) funkciju nevar izmantot.

Citu monitoru savienošana, izmantojot ziedlapķēdes savienojumu

Signāla ievadi DisplayPort 1 savienotājam vai USB-C savienotājam (augšupielāde: ) var izvadīt uz citu monitoru.

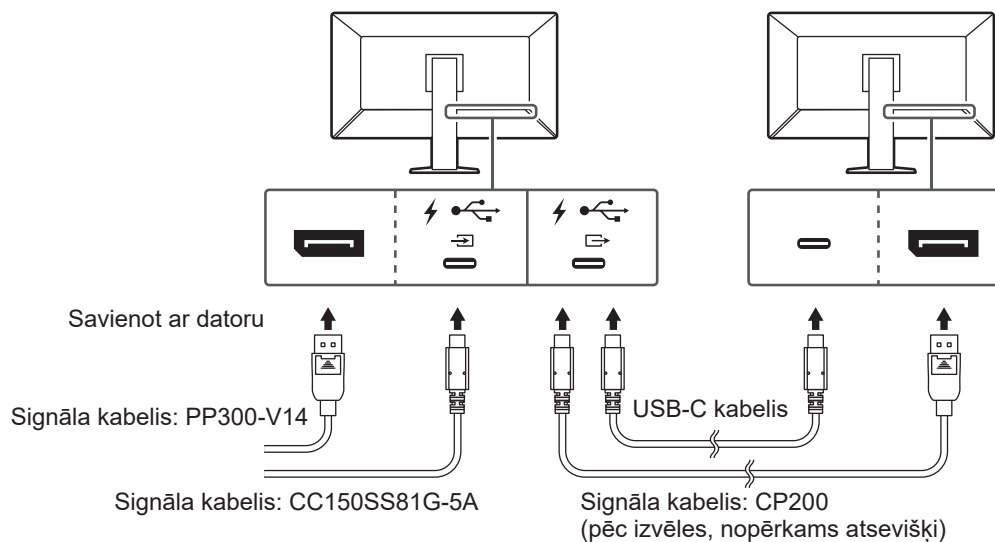


Uzmanību

- Apmeklējiet EIZO tīmekļa vietni, lai iegūtu informāciju par monitoriem un grafikas platēm, kādas var lietot ziedlapķēdes savienojumā: (www.eizoglobal.com)
- Lai iestatītu ziedlapķēdes savienojumu, pievienojiet DisplayPort 1 savienotāju vai USB-C savienotāju (augšupielāde: ) . Turklāt administratora iestatījumu izvēlnē ir jāiestata "Daisy Chain". Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu (kompaktdiskā).
- Rūpnīcas iestatījumos vāciņš tiek novietots virs USB-C (lejupielāde: ) . Lietojot noņemiet vāciņu.

2. Pieslēdziet strāvas vadu strāvas izejai un strāvas savienotājam uz monitora. Barošanas kabelis jāiesprauž monitorā līdz galam.

3. Ja neizmantojat USB-C savienojumu un ja izmantojat RadiCS/RadiCS LE vai monitoram pievienojat USB ierīci (perifēro ierīci, kas atbalsta USB), pievienojiet USB 2.0 kabeli monitora USB-B savienotājam un datora USB-A savienotājam.

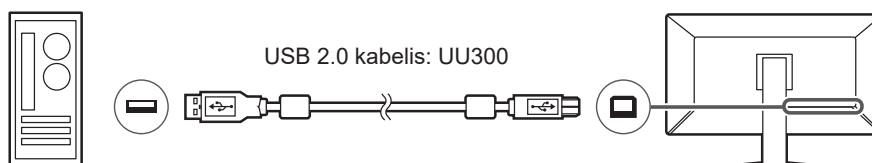

Ja izmantojat USB-C savienojumu un RadiCS/RadiCS LE vai monitoram pievienojat USB ierīci (USB pievienotu perifēro ierīci), iestatījumu izvēlnē iestatiet "USB Selection" uz "USB-C" (skatiet sadaļu "USB atlase" uzstādīšanas rokasgrāmatā).

Uzmanību

- Pievienojot monitoru datoram, kurā instalēts RadiCS/RadiCS LE, pievienojiet pie USB-B 1 (☞1) vai USB-C (augšupielāde: ☞).
- Izmantojot USB-B 2 (☞2), jau laikus noņemiet vāciņu. Turklāt iestatījumu izvēlnē mainiet iestatījumu "USB Selection" (skatiet sadaļu "USB atlase" uzstādīšanas rokasgrāmatā).

2.3 Ieslēgšana

1. Lai ieslēgtu monitoru, pieskarieties ☞. Monitora barošanas slēdža indikators iedegas zaļā krāsā. Ja strāvas indikators neiedegas, skatiet [3 Problēma Nav attēla \[► 30\]](#).

Piezīme

- Ja brīdī, kad monitors ir atslēgts no strāvas, jūs pieskarieties kādam darbības slēdzim, izņemot ☞, sāk mirgot ☞, informējot par strāvas slēdža atrašanās vietu.

2. Ieslēdziet datoru. Tiek parādīts ekrāna attēls. Ja attēls nepazūd, papildu ieteikumus skatiet šeit: [3 Problēma Nav attēla \[► 30\]](#).

Uzmanību


- Veicot savienojumu pirmo reizi vai mainot savienojuma veidu, displeja iestatījumi, piemēram, izšķirtspēja un displeja skala, var nebūt atbilstoši. Pārbaudiet, vai datora iestatījumi ir pareizi konfigurēti.
- Enerģijas taupīšanas nolūkos ieteicams izslēgt barošanas pogu. Nelietojot monitoru, var izslēgt galveno barošanu vai atvienot barošanas kabeļa kontaktdakšu, lai barošanu pārtrauktu pilnībā.

Piezīme

- Lai iespējami paildzinātu monitora kalpošanas laiku, aizkavējot spilgtuma pavājināšanos, un lai mazinātu enerģijas patēriņu, rīkojieties šādi:
 - Izmantojiet datora vai monitora enerģijas taupīšanas funkciju.
 - Pēc lietošanas izslēdziet monitoru.

2.4 Ekrāna augstuma un leņķa regulēšana

Turiet monitora augšējo un apakšējo vai kreiso un labo malu ar abām rokām un noregulējiet ekrāna augstumu, sasvērumu un pavērsumu optimāliem darba apstākļiem.

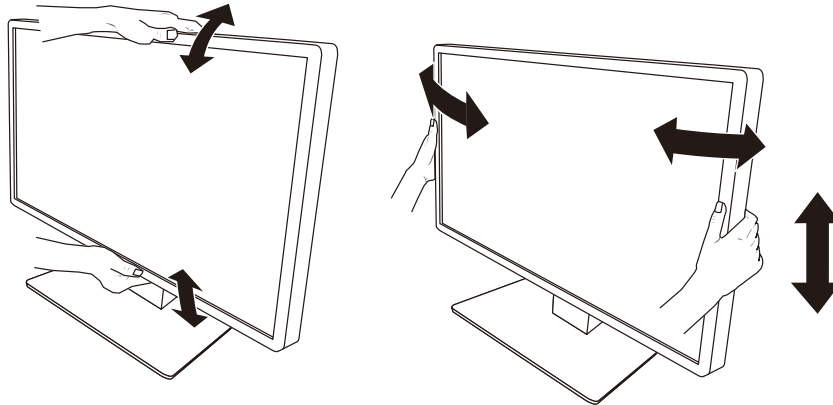


Uzmanību

- Pēc tam, kad ieregulēšana pabeigta, pārliedzinieties, vai kabeļi ir savienoti pareizi.
- Pēc augstuma un leņķa noregulēšanas izvelciet kabeļus caur kabeļu turētāju.

3 Problēma Nav attēla

Barošanas slēdža indikators neiedegas

- Pārlicinieties, vai strāvas vads ir pievienots pareizi.
- Ieslēdziet galveno strāvas slēdzi monitora aizmugurē.
- Pieskarieties .
- Izslēdziet un atkal ieslēdziet galveno strāvas padevi monitora aizmugurē pēc dažām minūtēm.

Barošanas slēdža indikators iedegas: Zaļš

- Iestatījumu izvēlnē palieliniet opciju "Brightness", "Contrast" vai "Gain" vērtības. Sīkāku informāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā (CD-ROM).
- Izslēdziet un atkal ieslēdziet galveno strāvas padevi monitora aizmugurē pēc dažām minūtēm.

Barošanas slēdža indikators iedegas: Oranžs

- Pārslēdziet ievades signālu. Sīkāku informāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā (CD-ROM).
- Pārvietojiet peli vai nospiediet kādu tastatūras taustiņu.
- Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts.
- Pārlicinieties, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Pievienojiet signāla kabeļus atbilstošā ievades signāla savienotājiem.
- Izslēdziet un atkal ieslēdziet galveno strāvas padevi monitora aizmugurē.


Barošanas slēdža indikators mirgo: Oranžs, Zaļš

- Izveidojiet savienojumu, izmantojot EIZO norādīto signāla kabeli. Pēc tam izslēdziet un atkal ieslēdziet galveno strāvas padevi pēc dažām minūtēm.

Ekrānā tiek parādīts ziņojums "No Signal".


Piemērs.



- Iepriekš redzamais ziņojums var parādīties tāpēc, ka daži datori nenodrošina signāla izvadi tūlīt pēc ieslēgšanas.
- Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts.
- Pārlicinieties, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Pievienojiet signāla kabeļus atbilstošā ievades signāla savienotājiem.
- USB-C (lejupielāde: ) tiek izmantots ziedlapķēdes savienojuma izvadei. Ekrāns netiek rādīts pat tad, ja ir izveidots savienojums ar datoru.
- Pārslēdziet ievades signālu. Sīkāku informāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā (CD-ROM).
- Izslēdziet un atkal ieslēdziet galveno strāvas padevi monitora aizmugurē.


Ekrānā tiek parādīts ziņojums “Signal Error”.

Piemērs.



- Pārbaudiet, vai dators ir konfigurēts atbilstoši monitora izšķirtspējas un vertikālās skenēšanas frekvences prasībām (skatiet [4.2 Saderīgās izšķirtspējas \[▶ 34\]](#)).
- Atsāknējiet datoru.
- Atlasiet atbilstošu iestatījumu, izmantojot grafikas plates utilītu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet grafikas plates lietotāja rokasgrāmatu.

Ekrānā tiek parādīts ziņojums “DP Unsupported”



- Pārbaudiet, vai pievienotais kabelis ir EIZO ieteikts signāla kabelis.
- Pārbaudiet, vai pievienotās ierīces USB-C atbalsta video signāla izvadi (DisplayPort Alt režīms). Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar ierīces ražotāju.
- Pievienojiet DisplayPort kabeli vai HDMI kabeli.

4 Specifikācijas

4.1 Specifikāciju saraksts

4.1.1 LCD panelis

Veids	IPS (neapžilbinošs)
Aizmugurgaismojums	Gaismas diode
Izmērs	30,5" (77,5 cm)
Izšķirtspēja	4096 punkti x 2160 līnijas
Displeja izmērs (H x V)	685,7 mm x 361,6 mm
Pikseļu solis (H x V)	0,167 mm x 0,167 mm
Displeja krāsas	10 bitu krāsas (DisplayPort / USB-C): līdz 1,07 miljardiem krāsu (no apmēram 543 miljardu krāsu paletes) 8 bitu (DisplayPort/HDMI): 16,77 miljoni krāsu (no apmēram 543 miljardu krāsu paletes)
Skata leņķis (H/V, tipisks)	178°/178°
Ieteicamais spilgtums	270 cd/m ²
Kontrasta attiecība (tipiskā)	1800:1
Reakcijas laiks (tipiskais)	25 ms (melns -> balts -> melns)

4.1.2 Video signāli

Ievades termināļi	DisplayPort x 2, USB-C (DisplayPort Alt režīms) x 1, HDMI x 1	
Izvades termināļi	USB-C (DisplayPort Alt režīms) x 1	
Horizontālās meklēšanas frekvence	DisplayPort, USB-C	31 kHz–134 kHz
	HDMI	31 kHz–136 kHz
Vertikālās meklēšanas frekvence ^{*1}	59 Hz–61 Hz (720 x 400: 69 Hz–71 Hz)	
Kadru sinhronizācijas režīms	59 Hz–61 MHz	
Punkta pulkstenis	DisplayPort, USB-C	25 MHz–570 MHz
	HDMI	25 MHz–600 MHz

*1 Atbalstītā vertikālās meklēšanas frekvence atšķiras atkarībā no izšķirtspējas. Plašāku informāciju skatiet [4.2 Saderīgās izšķirtspējas](#) [► 34].

4.1.3 USB

Ports	Augšupielāde	USB-C x 1, USB-B x 2
	Lejupielāde	USB-A x 3, USB-C x 1
Standarta	USB specifikācijas pārskatījums 2.0	
Saziņas ātrums	480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps	
Strāvas padeve	Augšupielāde	USB-C: maksimāli 94 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,7 A)
	Lejupielāde	USB-A: maksimāli 500 mA vienam portam USB-C: maksimāli 15 W (5 V/3 A)

4.1.4 Tīkls

Ports	RJ-45 (USB LAN adapteris)
-------	---------------------------

Atbalstītās operētājsistēmas ^{*1}	Windows 11 Windows 10 (32 bitu / 64 bitu) macOS Sierra (10.12.) vai jaunāka versija
Vadu LAN	IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)

*1 EIZO atbalsts beigsies, kad beigsies OS piegādātāju atbalsts.

4.1.5 Jauda

Ievade	100–240 V maiņstrāva ±10%, 50/60 Hz, 2,65–1,15 A
Maksimālais strāvas patēriņš	260 W vai mazāk
Enerģijas taupīšanas režīms	0,5 W vai mazāk ^{*1}
Gaidstāves režīms	0,5 W vai mazāk ^{*2}

*1 Kad izmanto DisplayPort importēšanu un USB augšupielādes ports nav pievienots, "DP Power Save": "On": "One Cable PbyP": "Off": "Daisy Chain"–"Output": "Off", nekāda ārēja slodze nav pievienota

*2 Kad USB augšupielādes ports nav pievienots, "DP Power Save": "On": "One Cable PbyP": "Off": "Daisy Chain"–"Output": "Off", nekāda ārēja slodze nav pievienota

4.1.6 Fiziskās specifikācijas

Izmēri (P x A x Dz)	721,0 mm x 469,5 mm–569,5 mm x 225,1 mm (sasvēršana: 0°) 721,0 mm x 507,9 mm–607,9 mm x 273,8 mm (sasvēršana: 30°)
Izmēri (P x A x Dz) (bez statīva)	721,0 mm x 401,0 mm x 73,0 mm
Neto svars	Apt. 12,4 kg
Neto svars (bez statīva)	Apt. 8,2 kg
Augstuma regulēšanas diapazons	100 mm (sasvēršana: 0°)
Sasvēršana	Uz augšu 30°, uz leju 5°
Pagriešana	70°

4.1.7 Darbības vides prasības

Temperatūra	0 °C–35 °C
Mitrums	20%–80% RM (bez rāsas kondensāta)
Gaisa spiediens	540 hPa–1060 hPa

4.1.8 Transportēšanas/uzglabāšanas apstākļi

Temperatūra	-20 °C–60 °C
Mitrums	10%–90% RM (bez rāsas kondensāta)
Gaisa spiediens	200 hPa–1060 hPa

4.2 Saderīgās izšķirtspējas

Monitors atbalsta tālāk norādītās izšķirtspējas.

✓: Atbalstīts, -: Neatbalstīts

Izšķirtspēja	Vertikālās skenēšanas frekvence (Hz)	DisplayPort / USB-C			HDMI	
		Rādīšana vienā ekrānā	PbyP displejs	PinP displejs	Rādīšana vienā ekrānā	PinP displejs
640 x 480	59,940	✓	✓	✓	✓	✓
640 x 480	60,000	-	-	-	✓	✓
720 x 400	70,087	✓	✓	✓	✓	✓
720 x 480	59,940	-	-	-	✓	✓
720 x 480	60,000	-	-	-	✓	✓
800 x 600	60,317	✓	✓	✓	✓	✓
1024 x 768	60,004	✓	✓	✓	✓	✓
1200 x 1600	59,963	-	-	✓	-	✓
1200 x 1920	59,940	-	-	✓	-	✓
1280 x 720	59,940	-	-	-	✓	✓
1280 x 720	60,000	-	-	-	✓	✓
1280 x 1024	60,020	✓	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200	60,000	✓	✓	✓	✓	✓
1920 x 1080	59,940	-	-	-	✓	✓
1920 x 1080	60,000	-	-	-	✓	✓
1920 x 1200	59,950	-	-	✓ ^{*1}	-	✓ ^{*1}
2048 x 2160	59,975	-	✓ ^{*1}	-	-	-
3840 x 2160	59,940	-	-	-	✓	-
3840 x 2160	59,997	✓	-	-	-	-
3840 x 2160	60,000	-	-	-	✓	-
4096 x 2160	59,940	-	-	-	✓	-
4096 x 2160	59,983	✓ ^{*1}	-	-	-	-
4096 x 2160	60,000	-	-	-	✓ ^{*1}	-

*1 Ieteicamā izšķirtspēja

4.3 Piederumi

Atsevišķi ir pieejami tālāk norādītie piederumi.

Jaunāko informāciju par papildpiederumiem un informāciju par jaunāko saderīgo grafikas plati skatiet mūsu tīmekļa vietnē.

(www.eizoglobal.com)

Kalibrēšanas komplekts	RadiCS UX2 versija 5.1.2 vai jaunāka versija RadiCS Version Up Kit versija 5.1.2 vai jaunāka versija
Tīkla QC pārvaldības programmatūra	RadiNET Pro versija 5.1.2 vai jaunāka versija
Tīrīšanas komplekts	ScreenCleaner
Komforta gaismeklis lasītavām	RadiLight
VESA adapteris vienkāršotam klientam vai neliela izmēra datoram	PCSK-R1
Signāla kabelis (USB-C–DisplayPort)	CP200

Pielikums

Medicīnas standarts

- Jānodrošina, lai galasistēma atbilstu IEC60601-1-1 prasībai.
- Elektroaprīkojums var emitēt elektromagnētiskos viļņus, kuri var ietekmēt vai ierobežot monitoru vai izraisīt tā disfunkciju. Uzstādiet aprīkojumu kontrolētā vidē, kur var izvairīties no šādas ietekmes.

Iekārtas klasifikācija

- Aizsardzības pret elektrošoku veids: I klase
- EMC klase: IEC60601-1-2 1. grupa, B klase
- Medicīniskās ierīces klasifikācija (ES): I klase
- Eksploatācijas režīms: pastāvīgs
- IP klase: IPX0

EMC informācija

RadiForce MX317W spēj pareizi attēlot medicīniskos attēlus.

Paredzētā lietojuma apstākļi

RadiForce MX317W ir paredzēta izmantošanai tālāk norādītajā vidē.

- Profesionālās veselības aprūpes iestādes vide, piemēram, klīnikas un slimnīcas
- Dzīvesvietas, piemēram, dzīvesvietas un mājas, veselības aprūpes mājās vidē

RadiForce MX317W lietojumam nav piemērotas tālāk norādītās vietas.

- Veselības aprūpes mājās vide, izņemot dzīvesvietu
- Augstfrekvences ķirurģiskā aprīkojuma, piemēram, elektroķirurģisko nažu, tuvums
- Īsviļņu terapijas iekārtu tuvums
- MRI paredzēto medicīniskā aprīkojuma sistēmu telpa ar RF ekranējumu
- Ekranēta vieta Īpaši apstākļi
- Instalācija transportlīdzekļos, tostarp ātrās palīdzības transportā
- Citi īpaši apstākļi



BRĪDINĀJUMS

- RadiForce MX317W ir nepieciešami īpaši piesardzības līdzekļi attiecībā uz EMC, un tā ir jāuzstāda. Uzstādot un rīkojoties ar šo produktu, rūpīgi jāizlasa sadaļa "EMC informācija" un "PIESARDZĪBAS PASĀKUMI" šajā dokumentā un jāņem vērā turpmākie norādījumi.



BRĪDINĀJUMS

- RadiForce MX317W nevar izmantot blakus citām ierīcēm vai uz tām. Ja nepieciešams izmantot blakus vai vienu virs otra, aprīkojums vai sistēma jānovēro, lai pārbaudītu normālo darbību konfigurācijā, kurā tā tiks izmantota.



BRĪDINĀJUMS

- Lietojot portatīvu RF sakaru aprīkojumu, turiet to vismaz 30 cm (12 collu) atstatumā no jebkuras RadiForce MX317W daļas, arī kabeliem. Pretējā gadījumā var pasliktināties šī aprīkojuma veiktspēja.




BRĪDINĀJUMS

- Perona, kura pieslēdz papildaprīkojumu signāla ievades vai izvades daļai, konfigurējot medicīnisko sistēmu, ir atbildīga par sistēmas atbilstību IEC60601-1-2 prasībām.



BRĪDINĀJUMS

- Izmantojot RadiForce MX317W, nepieskarieties signāla ievades/izvades savienotājiem. Pretējā gadījumā var tikt ietekmēts parādītais attēls.

 BRĪDINĀJUMS
<ul style="list-style-type: none"> Noteikti jālieto produktam pievienotie vai arī EIZO ieteiktie kabeļi. Citu kabeļu lietojums, kas nav EIZO ieteikti, var būt šī aprīkojuma pastiprinātu elektromagnētisko emisiju vai samazinātas elektromagnētiskās imunitātes un nepareizas darbības cēlonis.

Signāla ports	Maks. kabeļa garums	Ekranēšana	Ferīta kodols	Ieteicamais kabelis
DisplayPort	3 m	Ekranēts	Bez ferīta kodola	PP300-V14
HDMI	3 m	Ekranēts	Ar ferīta kodolu	HH300PR
USB-C (augšupielāde)	1,5 m	Ekranēts	Bez ferīta kodola	CC150SS81G-5A
USB-C (lejupielāde)	2 m	Ekranēts	Bez ferīta kodola	-
USB-B (augšupielāde)	3 m	Ekranēts	Ar ferīta kodolu	UU300/MD-C93
USB-A (lejupielāde)	3 m	Ekranēts	Bez ferīta kodola	-
Ethernet	30 m	Neekranēts	Bez ferīta kodola	-
Mainstrāvas ieeja (vai mainstrāvas ievade)	3 m	Neekranēts	Bez ferīta kodola	Ar zemējuma vadu

Tehniskie apraksti

Elektromagnētiskās emisijas

RadiForce MX317W ir paredzēts izmantošanai tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē.

RadiForce MX317W klientam vai lietotājam ir jānodrošina RadiForce MX317W izmantošana šādā vidē.


Emisijas pārbaude	Atbilstība	Elektromagnētiskā vide – norādījumi
RF emisijas CISPR11	1. grupa	RadiForce MX317W izmanto RF enerģiju tikai savai iekšējai darbībai. Tāpēc tās RF emisija ir ļoti zema un, visticamāk, neizraisa traucējumus tuvējām elektroiekārtām.
RF emisijas CISPR11	B klase	RadiForce MX317W ir piemērots izmantošanai visās iestādēs, tostarp mājās un iestādēs, kuras ir tieši pievienotas sabiedriskajam zemsprieguma strāvas padeves tīklam, kas apgādā sadzīves nolūkos izmantojamās ēkas.
Saskaņotās emisijas IEC61000-3-2	D klase	
Sprieguma svārstības/ mirgojošās emisijas IEC61000-3-3	Atbilst	

Elektromagnētiskā noturība

RadiForce MX317W ir pārbaudīta šādos atbilstības līmeņos (C) saskaņā ar pārbaudes prasībām (T) profesionālās veselības aprūpes iestāžu apstākļos un mājas veselības aprūpes vidē, kas norādīta standartā IEC60601-1-2.

RadiForce MX317W klientam vai lietotājam ir jānodrošina tās izmantošana šādā vidē.

Noturības pārbaude	Testa līmenis (T)	Atbilstības līmenis (C)	Elektromagnētiskā vide – norādījumi
Elektrostatiskā izlāde (ESD) IEC61000-4-2	±8 kV izlāde kontaktā ±15 kV izlāde gaisā	±8 kV izlāde kontaktā ±15 kV izlāde gaisā	Grīdām ir jābūt izgatavotām no koka, betona vai keramiskajām flīzēm. Ja grīdu segums ir sintētisks materiāls, relatīvajam gaisa mitrumam jābūt vismaz 30 %.
Straujas sprieguma svārstības/uzliesmojumi IEC61000-4-4	±2 kV elektroapgādes līnijas ±1 kV ievades/izvades līnijas	±2 kV elektroapgādes līnijas ±1 kV ievades/izvades līnijas	Elektrotīkla strāvas kvalitātei ir jāatbilst tipiskai komerciālai vai slimnīcas videi.
Pārspriegums IEC61000-4-5	±1 kV no līnijas uz līniju ±2 kV no līnijas uz zemi	±1 kV no līnijas uz līniju ±2 kV no līnijas uz zemi	Elektrotīkla strāvas kvalitātei ir jāatbilst tipiskai komerciālai vai slimnīcas videi.
Sprieguma kritumi, tsi pārtraukumi un sprieguma svārstības barošanas ievades līnijās IEC61000-4-11	0% U_T (U_T kritums 100%) 0,5 ciklos un 1 ciklā 70% U_T (U_T kritums 30%) 25 ciklos/50 Hz 0 % U_T (U_T kritums 100 %) 250 ciklos/ 50 Hz	0% U_T (U_T kritums 100%) 0,5 ciklos un 1 ciklā 70% U_T (U_T kritums 30%) 25 ciklos/50 Hz 0 % U_T (U_T kritums 100 %) 250 ciklos/ 50 Hz	Elektrotīkla strāvas kvalitātei ir jāatbilst tipiskai komerciālai vai slimnīcas videi. Ja RadiForce MX317W lietotājam ir nepieciešama nepārtraukta darbība elektrotīkla strāvas pārtraukumu laikā, ieteicams nodrošināt RadiForce MX317W barošanu no nepārtrauktā elektroapgādes avota vai akumulatora.
Sprieguma frekvences magnētiskais lauks IEC61000-4-8	30 A/m (50/60 Hz)	30 A/m	Magnētisko lauku enerģijas frekvencei ir jāatbilst parastās komerciālas vai slimnīcas vides raksturīgajam līmenim. Lietošanas laikā produkts jātur vismaz 15 cm atstatumā no sprieguma frekvences magnētisko lauku avota.

Noturības pārbaude	Testa līmenis (T)	Atbilstības līmenis (C)	Elektromagnētiskā vide – norādījumi
Vadītie RF lauku inducētie traucējumi IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz–80 MHz 6 Vrms ISM ^{*1} un amatieru radio ^{*2} joslas starp 150 kHz un 80 MHz	3 Vrms 6 Vrms	Portatīvo un mobilo RF sakaru aprīkojumu nevajadzētu izmantot tuvāk kādai RadiForce MX317W daļai, tostarp kabeļiem, par ieteikto atstatumu, kāds aprēķināts, izmantojot raidītāja frekvencei piemērojamo vienādojumu. Ieteiktais atstatums d = 1,2√P d = 1,2√P
Izstarotie RF lauki IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz–2,7 GHz	10 V/m	d = 1,2√, 80 MHz–800 MHz d = 2,3√P; 800 MHz–2,7 GHz Kur "P" ir raidītāja maksimālās izvades jaudas nomināls vatos (W) (pēc raidītāja ražotāja norādījumiem) un "d" ir ieteicamais atstatums metros (m). Fiksētu RF raidītāju lauku intensitātei, ko nosaka elektromagnētiskās pārraudzības protokols ^{*3} , ir jābūt mazākai par atbilstības līmeni katrā frekvenču intervālā ^{*4} . Traucējumi ir iespējami blakus iekārtām, kas ir marķētas ar šādu simbolu. 

Piezīme

- U_T ir maiņstrāvas spriegums pirms pārbaudes līmeņa piemērošanas.
- Pie 80 MHz un 800 MHz tiek izmantots augstāks frekvences diapazons.
- Šie norādījumi attiecībā uz vadītajiem RF lauku inducētajiem traucējumiem vai izstarotajiem RF laukiem var neattiekties uz visām situācijām. Elektromagnētisko izplatību ietekmē absorbcija un atstarošana no struktūrām, priekšmetiem un cilvēkiem.

*1 ISM (rūpniecības, zinātnes un medicīnas) joslas starp 150 kHz un 80 MHz ir 6,765 MHz–6,795 MHz; 13,553 MHz–13,567 MHz; 26,957 MHz–27,283 MHz un 40,66 MHz–40,70 MHz.

*2 0,15 MHz–80 MHz radioamatieru joslas ir 1,8 MHz–2,0 MHz, 3,5 MHz–4,0 MHz, 5,3 MHz–5,4 MHz, 7 MHz–7,3 MHz, 10,1 MHz–10,15 MHz, 14 MHz–14,2 MHz, 18,07 MHz–18,17 MHz, 21,0 MHz–21,4 MHz, 24,89 MHz–24,99 MHz, 28,0 MHz–29,7 MHz un 50,0 MHz–54,0 MHz.

*3 Lauku stiprumu no fiksētiem raidītājiem, piemēram, radio (mobilo/bezvadu) tālrunu un zemes mobilo radio, amatieru radio, AM un FM radio apraides un TV apraides bāzes stacijām nevar teorētiski paredzēt precīzi. Lai novērtētu fiksēto radioviļņu raidītāju radītos laukus, ir jāveic elektromagnētisko lauku mērījumi. Ja izmērītais lauka stiprums RadiForce MX317W izmantošanas vietā pārsniedz iepriekš minēto piemērojamo RF atbilstības līmeni, RadiForce MX317W jānovēro, lai pārliecinātos, vai tā darbojas normāli. Ja novērota nenormāla veiktspēja, var būt nepieciešami papildu pasākumi, piemēram, RadiForce MX317W pārorientācija vai pārvietošana.

*4 Frekvences diapazonam, kas pārsniedz 150 kHz līdz 80 MHz, lauka stiprumam jābūt mazāk nekā 3 V/m.

Ieteicamais atstatums starp portatīvajām vai mobilajām RF sakaru ierīcēm un RadiForce MX317W

RadiForce MX317W ir paredzēts izmantošanai elektromagnētiskā vidē, kurā tiek kontrolēti izstarotie RF traucējumi. RadiForce MX317W klients vai lietotājs var palīdzēt novērst elektromagnētiskos traucējumus, saglabājot minimālo atstatumu (30 cm) starp portatīvo un mobilo RF sakaru aprīkojumu (raidītājiem) un RadiForce MX317W. RadiForce MX317W ir pārbaudīts tālāk norādītajos atbilstības līmeņos (C) attiecībā uz nepieciešamajiem imunitātes pret elektromagnētisko lauku tuvumu pārbaudes līmeņiem (T) tālāk norādītajos RF sakaru pakalpojumos.

Testēšanas frekvence (MHz)	Joslās platums ^{*1} (MHz)	Pakalpojums ^{*1}	Modulācija ^{*2}	Testēšanas līmenis (T) ^{*3} (V/m)	Atbilstības līmenis (C) (V/m)
385	380–390	TETRA 400	Impulsa modulācija ^{*2} 18 Hz	27	27
450	430–470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz novirze 1 kHz sinuss	28	28
710 745 780	704–787	LTE josla 13, 17	Impulsa modulācija ^{*2} 217 Hz	9	9
810 870 930	800–960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE josla 5	Impulsa modulācija ^{*2} 18 Hz	28	28
1720 1845 1970	1700–1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE josla 1, 3, 4, 25; UMTS	Impulsa modulācija ^{*2} 217 Hz	28	28
2450	2400–2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE josla 7	Impulsa modulācija ^{*2} 217 Hz	28	28
5240 5500 5785	5100–5800	WLAN 802.11 a/n	Impulsa modulācija ^{*2} 217 Hz	9	9

*1 Attiecībā uz dažiem pakalpojumiem ir iekļautas tikai augšpusaites frekvences.

*2 Nesējs ir modulēts, izmantojot 50% darba cikla kvadrāta viļņa signālu.

*3 Testa līmeņi tika aprēķināti, izmantojot maksimālo jaudu un 30 cm atdalīšanas attālumu.

Klients vai RadiForce MX317W lietotājs var novērst traucējumus, ko izraisa tuvumā esoši magnētiskie lauki, saglabājot minimālo attālumu (15 cm) starp RF raidītāju un RadiForce MX317W. RadiForce MX317W ir pārbaudīts tālāk norādītajos atbilstības līmeņos (C) nepieciešamajiem tuvuma magnētiskā lauka noturības testa līmeņiem (T).

Pārbaudes frekvence	Modulācija	Pārbaudes līmenis (T) (A/m)	Atbilstības līmenis (C) (A/m)
30 kHz	CW (nepārtraukts vilnis)	8	8
134,2 kHz	Impulsu modulācija* ¹ 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Impulsu modulācija* ¹ 50 kHz	7,5	7,5

*¹ Nesējs ir modulēts, izmantojot 50% darba cikla kvadrāta viļņa signālu.

Cita portatīvā un mobilā RF sakaru aprīkojuma (raidītāju) gadījumā minimālais atstātums starp portatīvo un mobilo RF sakaru aprīkojumu (raidītājiem) un RadiForce MX317W jā saglabā atbilstoši turpmākajiem ieteikumiem, saskaņā ar sakaru aprīkojuma maksimālo izvades jaudu.

Raidītāja nominālā maksimālā izvades jaua (W)	Atstātums saskaņā ar raidītāja frekvenci (m)		
	150 kHz–80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz–800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz–2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Raidītājiem, kuru nominālā maksimālā izvades jauda nav norādīta iepriekš, ieteicamo atstatumu "d" metros (m) var noteikt, izmantojot raidītāja frekvencei piemērojamu vienādojumu, kur "P" ir raidītāja maksimālais izvades jaudas nomināls vatos (W) saskaņā ar raidītāja ražotāja norādījumiem.

Piezīme
<ul style="list-style-type: none"> • Pie 80 MHz un 800 MHz tiek izmantots atstātums, kāds jāpiemēro augstākam frekvences diapazonam. • Šie norādījumi attiecinās uz vadītājiem RF lauku inducētajiem traucējumiem vai izstarotajiem RF laukiem var neattiekties uz visām situācijām. Elektromagnētisko izplatību ietekmē absorbcija un atstarošana no struktūrām, priekšmetiem un cilvēkiem.




EIZO Corporation 
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH 
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

艺卓显像技术(苏州)有限公司
中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

EIZO Limited 
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG 
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N404AZ
IFU-MX317W